

FORWATER

# 濬創科技有限公司

FORWATER Measurement System Corp.

24161 新北市三重區重新路四段 97 號 3 樓之 2 Tel:02-2972-5528 Fax:02-2973-7885  
3F.-2, No.97, Sec. 4, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 24161, Taiwan (R.O.C.)

## 銷售暨保固證明書

客 戶：續翔節能股份有限公司

產品名稱：超音波流量計

項次	設備	數量
1	管夾式超音波流量計 ENV-880F	2

上述貨物為本公司於 114 年 12 月 30 日出貨給續翔節能股份有限公司。且對上述貨物保固責任為交貨日起算一年整。(如因天災、地變、人力不可抗拒之事件，耗材及人為因素造成等，不在本保固範圍內。)

此致

續翔節能股份有限公司

濬創科技有限公司




負責人：林湘澄



中 華 民 國 一 一 四 年 十 二 月 三 十 日

# 進口報單

海空運別(1)	空	報單類別(2)	G1	聯別	2.進口證明用聯	頁次	第 1 頁 / 共 2 頁
報單號碼(3)	CF/ /14/550/JG522					海關通關號碼(4)	

船舶名稱/航機代碼(5)	N870FD		主提單號碼(8)	023-26260253		匯率(16)	****			
船舶呼號(6)	船舶航次/航機班次(7)	FX 5140	分提單號碼(9)	880588130923		離岸價格(17)	幣別 金額 *** *****			
裝貨港名稱/代碼(10)	Bengbu	CNBEU	國外出口日期(13)	114/04/20	進口日期(14)	114/04/20	運費(18) *** *****			
卸存地代碼(11)	003C2023	進口運輸方式代碼(12)	42	報關日期(15)	114/04/21	保險費(19)	*** *****			
納稅義務人(24)	統一編號(23)	27342542	海關監管編號(25)		特殊關係(26)	135	稅費繳納方式(27)	2	應加減費用(20)(21)	*** *****
	中文名稱	濟創科技有限公司 02-29725528			AEO編號		起岸價格(22)		*** *****	
	英文名稱	FORWATER Measurement System Corp.					簽證情形(28)		案號(29)	737723416579
	中/英文地址	新北市三重區重新路4段97號3樓之2/3F-2, NO. 97, SEC. 4, CHONGXIN RD., SANCHONG								
賣方(30)	中文名稱				AEO編號					
	英文名稱	WESS GLOBAL INC.								
	中/英文地址	/B-8F, Ace high-tech city, 10 Backsokgongdan 1-ro, Seobuk-gu, Cheonan, Korea, 3109, , , , KR								
國家代碼(31)	KR	統一編號(32)	AEOET	海關監管編號(33)						
項次(34)	生產國別(36)	輸出入許可文件號碼-項次(37)	輸出入貨品分類號列(38)	檢查號碼	條件、幣別	淨重(公斤)(40)	價格完稅(43)	進口稅率(44)	從價	納稅辦法(45)
	貨物名稱、商標(牌名)及規格等(35)	稅則號別	統計號別	單價(39)	金額	數量(單位)(41) (統計用)(42)	數量	從量	貨物稅率(46)	
1	KR	NIL 90261091000		***	***	4.704 40 SET (40 SET)	*****	***	***	***
2	KR	NIL 90269000003		***	***	2.0384 40 SET	*****	***	***	***
總件數/單位(47)	2	CTN	包裝說明(48)			總毛重(公斤)(49)	19.6			
標記(50)/貨櫃號碼(51)/其他申報事項(52)						進口稅	*****			
N/M						推廣貿易服務費	*****			
一般委任核准文號110業二14769號110.08.21--114.08.21止						營業稅	*****			
收貨人代碼:NIL						稅費合計	*****			
發貨人代碼:NIL						營業稅稅基	*****			
  						通關方式	C1	(申請) 審驗方式		
						證明文件申請	聯別	2	份數	1
						報關人/AEO編號(53)	荷蘭商聯邦快遞國際股份有限公司台灣分公司 550A 02-25369090			
						專責人員(54)	羅秀玉 00363			

財政部關稅署

為應輸出人資料保護之需求，本報單副本部分欄位空白




# ULTRASONIC FLOWMETER CALIBRATION REPORT



CONDIZIONI DI PROVA/TEST CONDITION

MODEL: **ENV880F**  
 S/N: 21027672  
 DN 200 mm  
 COEFFICIENT: **KA1**  
 DATE: 10th/APR/2025

TEST (N°)	FLOW RATE (m <sup>3</sup> /h)	TEST VELOC. (m/s)	AMB.TEMP. (°C)	WAT.TEMP. (°C)	VOL. MASTER (l)	VOLUME TEST (l)	ERROR (%)	TEST (N°)
1	169.4251	1.5	15.8	13.8	14096.471	14221.025	0.88	1
2	170.0816	1.5	15.8	13.8	14166.494	14188.790	0.16	2
3	169.8060	1.5	15.8	13.8	14117.973	14228.812	0.79	3
4	344.8181	3.0	15.9	13.6	27928.769	28053.344	0.45	4
5	341.0401	3.0	15.7	13.6	27991.922	28053.796	0.22	5
6	339.0663	3.0	15.8	13.6	27962.837	28038.801	0.27	6

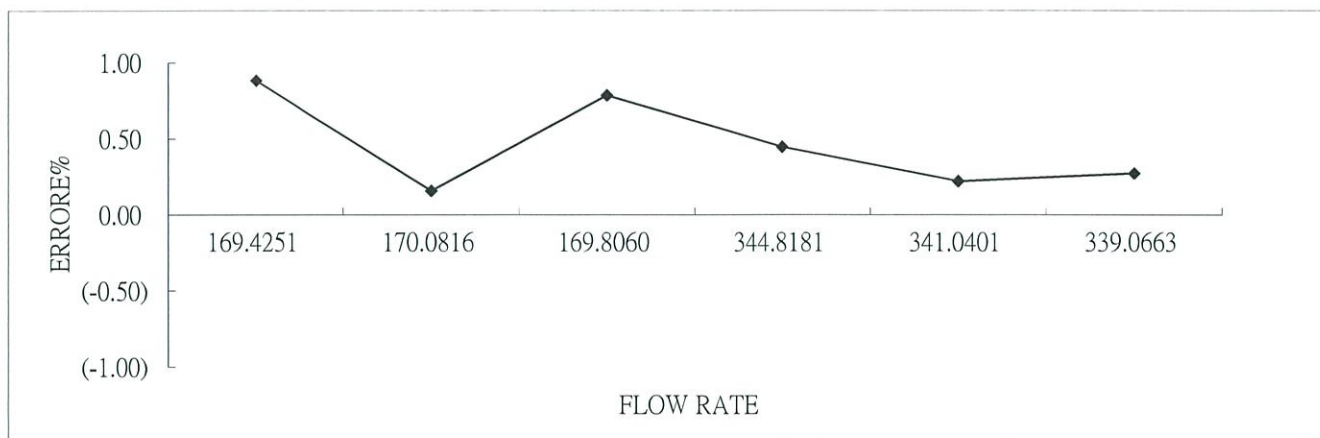

Operator: Sherten




# ULTRASONIC FLOWMETER CALIBRATION REPORT



CONDIZIONI DI PROVA/TEST CONDITION

MODEL: **ENV880F**  
 S/N: 21027664  
 DN 200 mm  
 COEFFICIENT: **KA1**  
 DATE: 10th/APR/2025

TEST (N°)	FLOW RATE (m <sup>3</sup> /h)	TEST VELOC. (m/s)	AMB.TEMP. (°C)	WAT.TEMP. (°C)	VOL. MASTER (l)	VOLUME TEST (l)	ERROR (%)	TEST (N°)
1	169.0862	1.5	15.8	13.8	14145.015	14203.101	0.41	1
2	169.4183	1.5	15.8	13.8	14175.443	14239.289	0.45	2
3	169.2112	1.5	15.8	13.8	14163.285	14185.812	0.16	3
4	340.8898	3.0	15.9	13.6	27928.919	28026.592	0.35	4
5	340.0373	3.0	15.7	13.6	27982.118	28044.222	0.22	5
6	339.0401	3.0	15.8	13.6	27927.581	28098.948	0.61	6

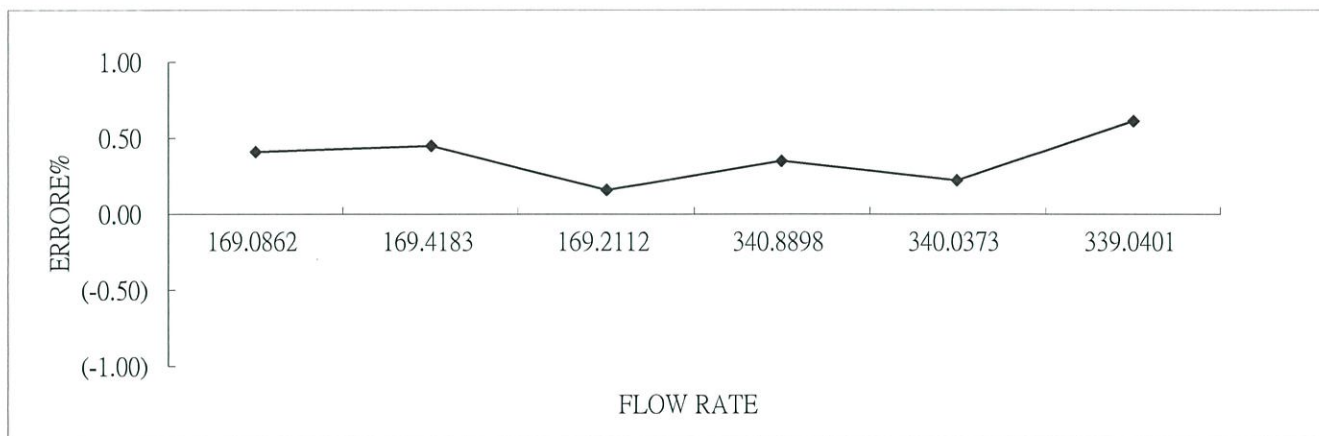

Operator: Sherten



# SIPIN

## 矽品科技有限公司

SIPINTECHNOLOGYCO.,LTD

414 台中市烏日區溪南路一段 988 巷 296 弄 39 號 TEL : (04) 2335-0458 FAX : (04) 2335-7625

E-mail : [sipinscr@ms75.hinet.net](mailto:sipinscr@ms75.hinet.net) <http://www.scr.com.tw> <http://www.sipin.com.tw>

---

### 產品出廠證明書暨保固書

證明售予 續翔節能股份有限公司

1. 記錄器 PR2006-0A2111S2 \* 2 台  
序號 254070017~18
2. 補償導線 T 鐵氟龍 TC-CC-TF 0.3/1\*2 棕色 \* 200M

保固期限：自出貨日起壹年內

上係由本公司出貨銷售 特此證明

出貨廠商：矽品科技有限公司

負責人：廖文源

地址：台中市烏日區溪南路一段 988 巷 296 弄 39 號



中 華 民 國      114      年      12      月      31      日

## 出廠及保固證明書

茲證明續翔節能股份有限公司所購買之下列設備為本公司於民國 114 年 12 月 31 日所出廠，並為未經使用之全新品，且完全符合本公司出廠檢驗之標準程序規範。本公司願遵照維修服務之規定，提供該案下述設備之售後服務保證，以確保使用單位之權益。

設備名稱/規格/數量：

設備名稱	數量
負載記錄電力表 PA310-50	1
負載記錄電力表 PA310-80	1

保固期間：114 年 12 月 31 日至 115 年 12 月 30 日止，共計壹年。

### 特此證明

玖鼎電力資訊股份有限公司

地 址：新竹市香山區景觀大道 256-15 號

電 話：03-5631359

傳 真：03-5631663



中 華 民 國 一 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 開 立



# 新逸股份有限公司

ECOA TECHNOLOGIES CORP.


## 出廠證明

承 包 商：續翔節能股份有限公司

出廠日期：中華民國114年12月31日

本公司僅此特出具下述產品之出貨證明書。

品名	數量	單位
水差壓傳訊器	2	只
(以下空白)		



中 華 民 國 一 百 一 十 四 年 十 二 月 三 十 一 日 開 立